Procedura wykrywania gorączki. ISO 13154




Wejście

Relaks


Do 15min

Otoczenie:
20-24 °C
10-50 %RH

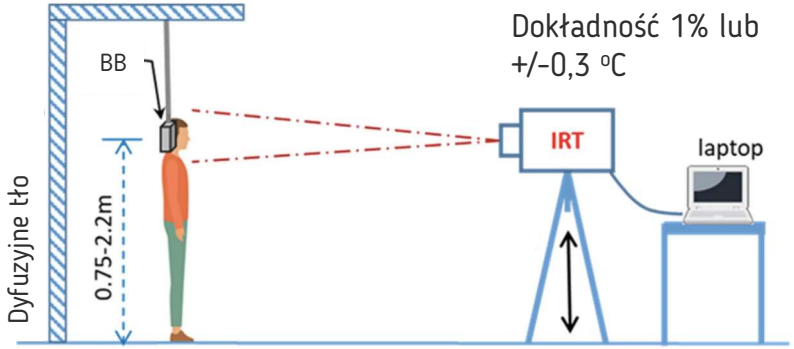

Pomieszczenie bez nadmuchu i przeciągów

BB – jeżeli wymagane przez producenta do osiągnięcia dokładności

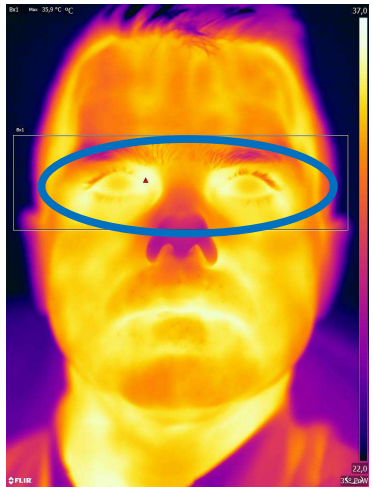



Gdy T>37,5°C
Dodatkowa kontrola